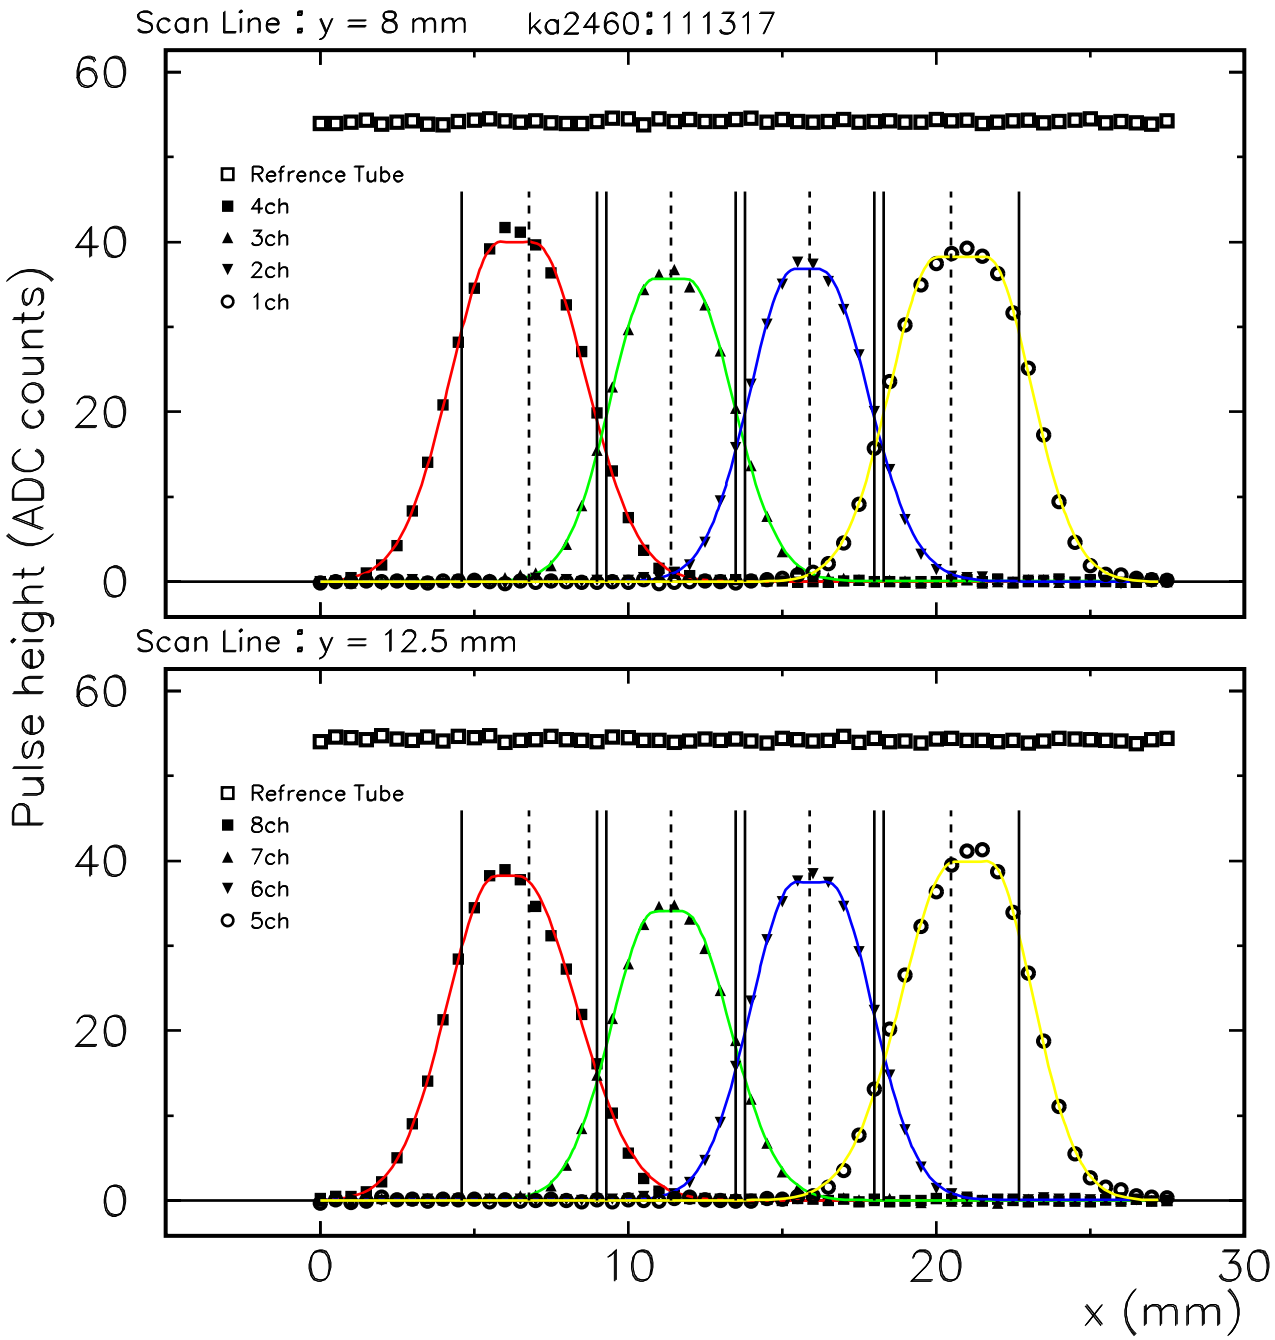
Scan Line : y = 8 mm
ka2460:111317
Refrence Tube
4ch
3ch
2ch
1ch
Scan Line : y = 12.5 mm
Refrence Tube
8ch
7ch
6ch
5ch
Pulse height (ADC counts)
x (mm)
0
20
40
60
0
10
20
30

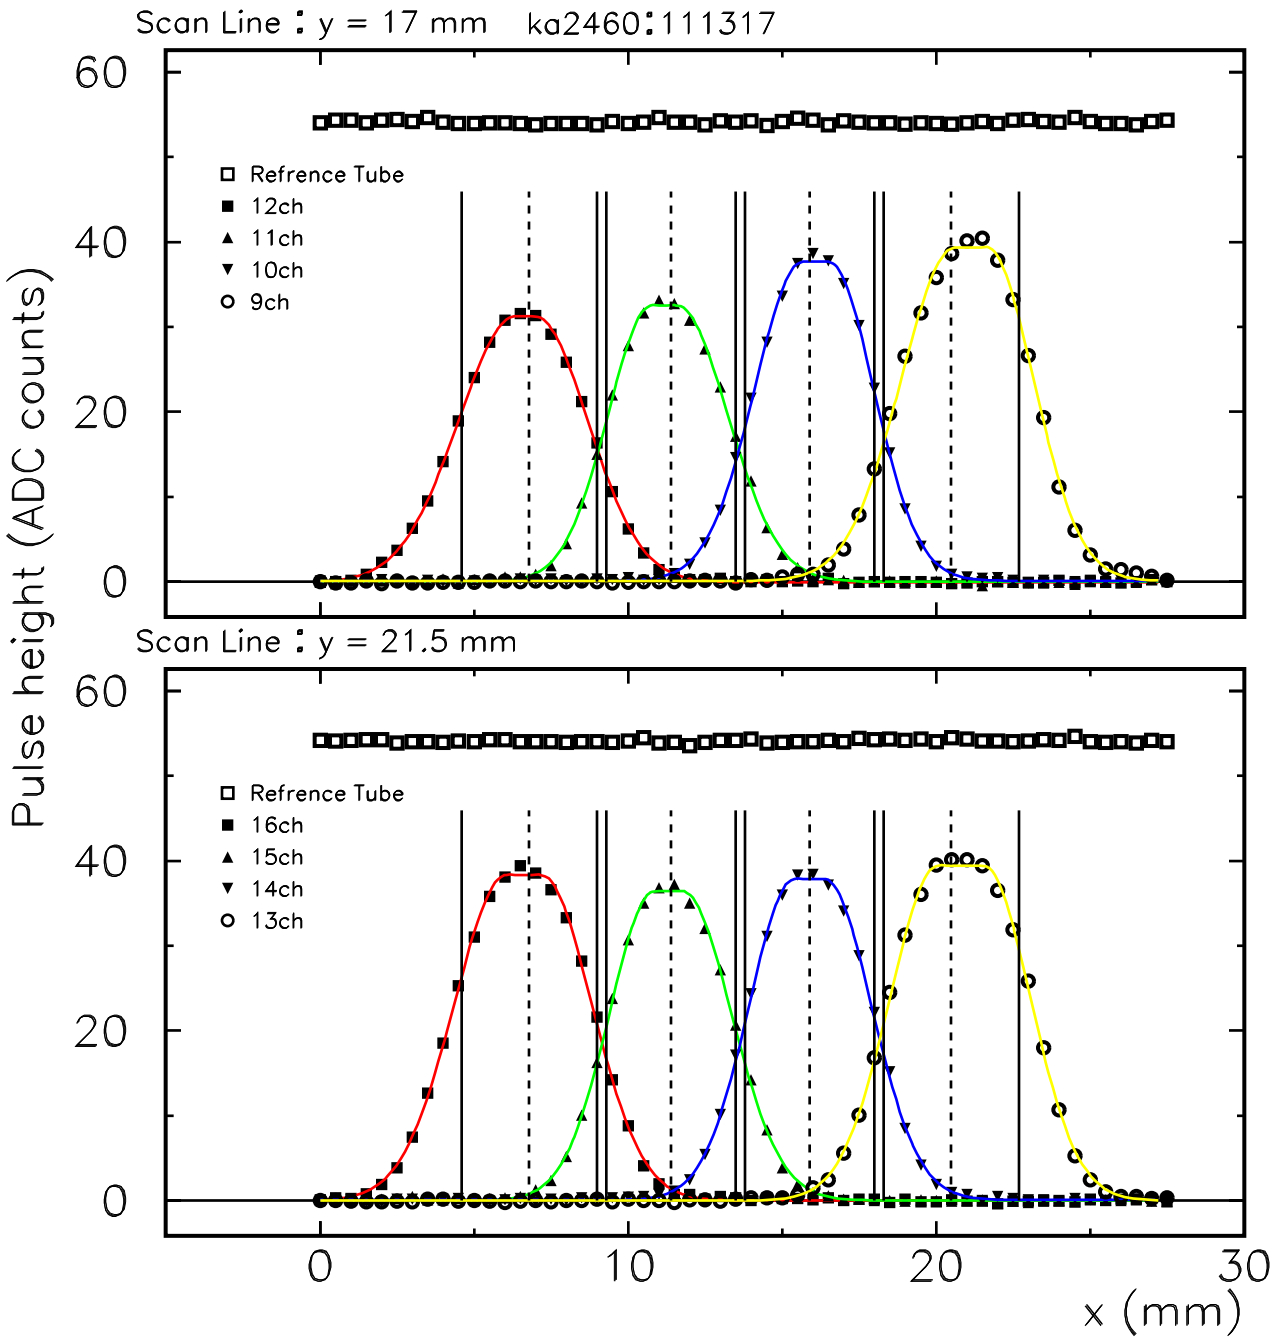
Scan Line : y = 17 mm ka2460:111317
Refrence Tube
12ch
11ch
10ch
9ch
Scan Line : y = 21.5 mm
Refrence Tube
16ch
15ch
14ch
13ch
Pulse height (ADC counts)
x (mm)
0
20
40
60
0
10
20
30

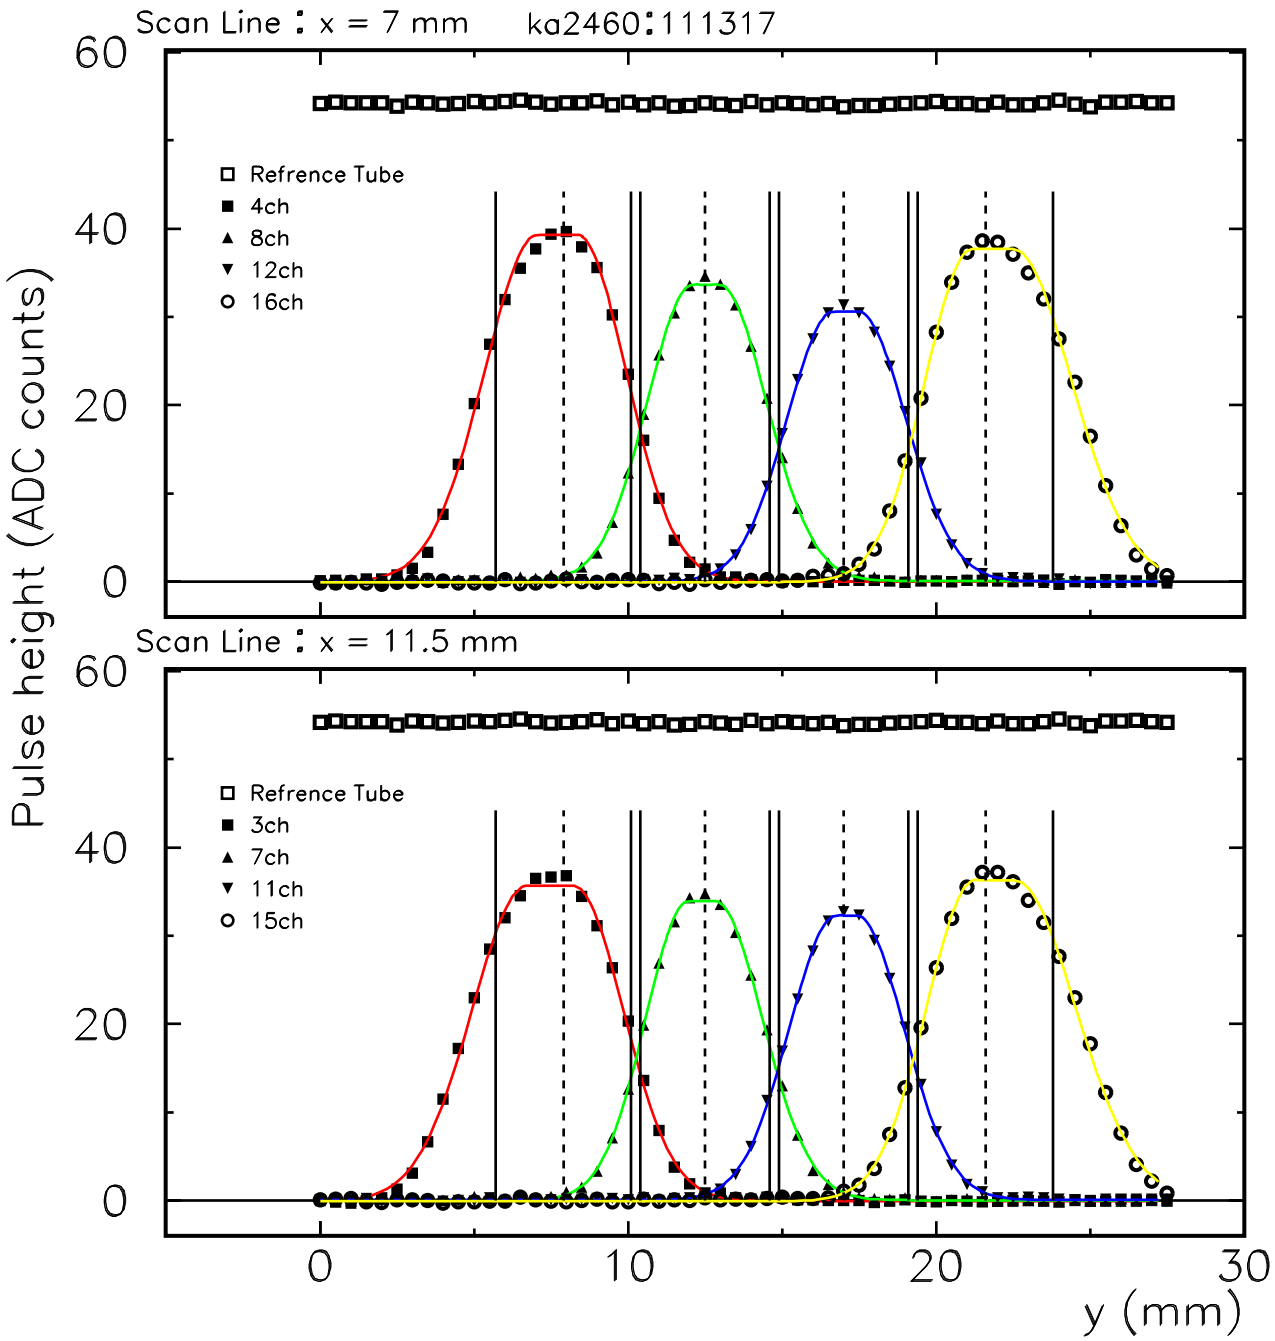
Scan Line : x = 7 mm
ka2460:111317
Refrence Tube
4ch
8ch
12ch
16ch
Scan Line : x = 11.5 mm
Refrence Tube
3ch
7ch
11ch
15ch
Pulse height (ADC counts)
y (mm)
0
20
40
60
0
10
20
30

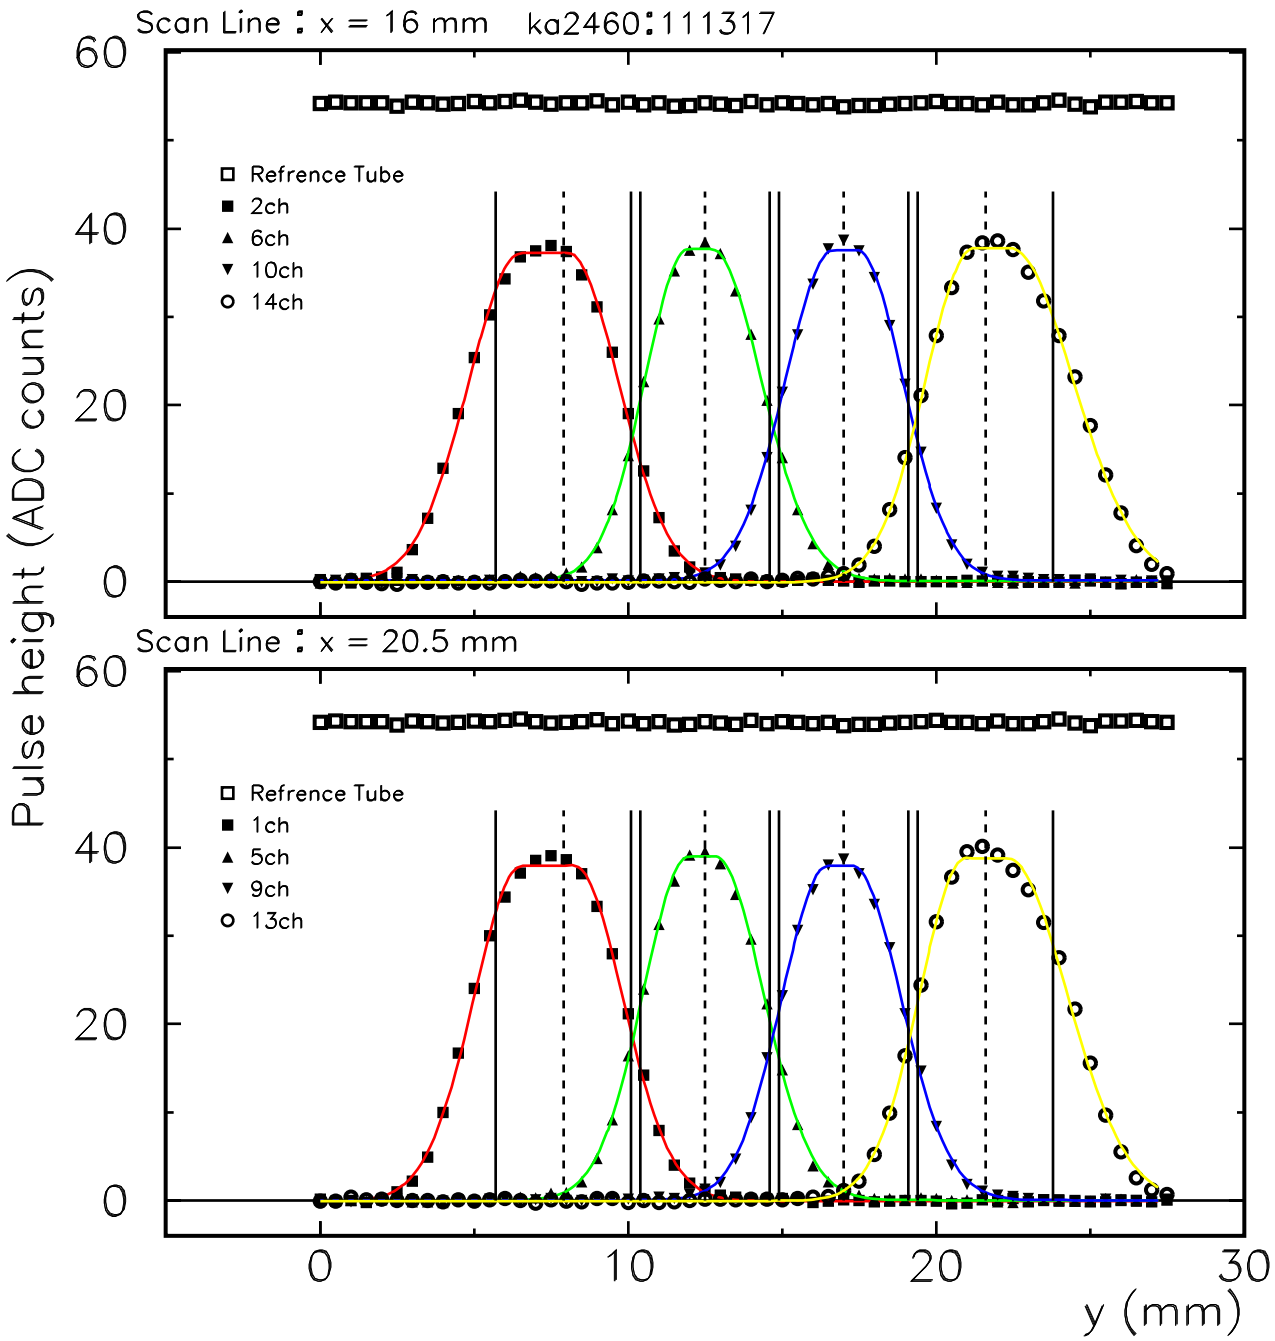
Scan Line : x = 16 mm ka2460:111317
Refrence Tube
2ch
6ch
10ch
14ch
Scan Line : x = 20.5 mm
Refrence Tube
1ch
5ch
9ch
13ch
Pulse height (ADC counts)
y (mm)
0
20
40
60
0
10
20
30